

Wrocław, 16.10.2015r.

EZPL/1484/15

Wg rozdzielnika

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 1

Dotyczy: Przetarg nieograniczony -Przeinstalowanie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu firmy Varian Medical Systems, to jest akceleratora wieloenergetycznego o nazwie Clinac 2100 CD nr ser. 4069 wraz z wyposażeniem z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu do Filii Zamawiającego w Jeleniej Górze (w budowie) z czasowym przechowaniem w magazynie Wykonawcy., znak: ZP/PN/75/15/LZT

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niżej opisany sposób.

Zmiana nr 1 SIWZ:

W załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna akceleratora w akapicie pn.: „Uwagi do instalacji w Filii – por. załącznik 7 „rzut parteru Filii w Jeleniej Górze” dodaje się punkty e) – g) o brzmieniu:

e) W bunkrze, na suficie, Wykonawca zainstaluje 5 haków niezbędnych do re-instalacji akceleratora. Rysunki haków, ich układ i obciążenia poniżej,

f) Wykonawca podczas uruchamiania akceleratora przyłączy go do rur elastycznych 3/4" (z/do panelu chłodzenia w pom. technicznym) i wykona regulację obiegu chłodniczego poprzez ustawienie prędkości obrotowej [rpm] pompy i nastawienie parametrów w sterowniku. Czynności należy prowadzić pod nadzorem inżyniera z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (wykonawcze lub projektowe – instalacji sanitarnych), a wyniki zawrzeć protokolarnie w formie dokumentacji powykonawczej.

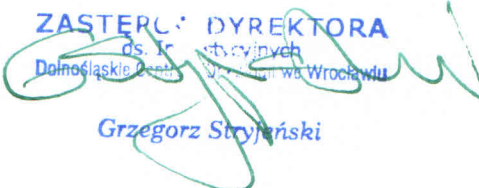
g) Wykonawca przyłączy akcelerator do szafy elektrycznej TP0.4 lub TP0.5 pod nadzorem inżyniera z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (wykonawcze lub projektowe – instalacji elektrycznych), a wyniki (szkic i specyfikacja kabla przyłączeniowego) zawrzeć protokolarnie w formie dokumentacji powykonawczej.

Ponadto dodaje się do Załącznika nr 1 rysunki haków, ich układ i obciążenia, o których mowa w pkt e).

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ załączono do niniejszego wyjaśnienia z oznaczeniem zmian kolorem.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zamówień Publicznych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Strykowski